② X2: - IC 9/14
- IC 10/14
- IC 11/1
- IC 12/14

Anmerkung:
+ C5-C6-C9-C10-C12-C15-C16-C18-C19-C20-C21-C24
Wert: von 0,68µF bis 2,2µF
+ R98
nur erforderlich, wenn P2-Abgleich nicht möglich

		Werkstückkanten nach DIN 6784	Allgemeintoleranzen DIN 7168-C mittel	Oberflächen Angaben nach ISO 1302 R_z nach DIN 4768	Maßstab	Gewicht	Ansichten Methode E-ISO R 128
					Werkstoff		
					Rohteil-Nr.		
				Datum / Name	Benennung		
			Bearb.	1.2.92 Aglaster	Flächenheizung		
			Gepr.				
			Norm				
			Abt.	Ges.			
2	Alarmsignal	1.9.92	WEYER GmbH		Charakter: SPED	Form	Techn. Ordnungsnummer: 0036
Mikr. Zust.	Änderung	Dat. / Na. Gepr.	Urspr.		Ers. für		Ers. durch

Blatt 1 von 1 Bl

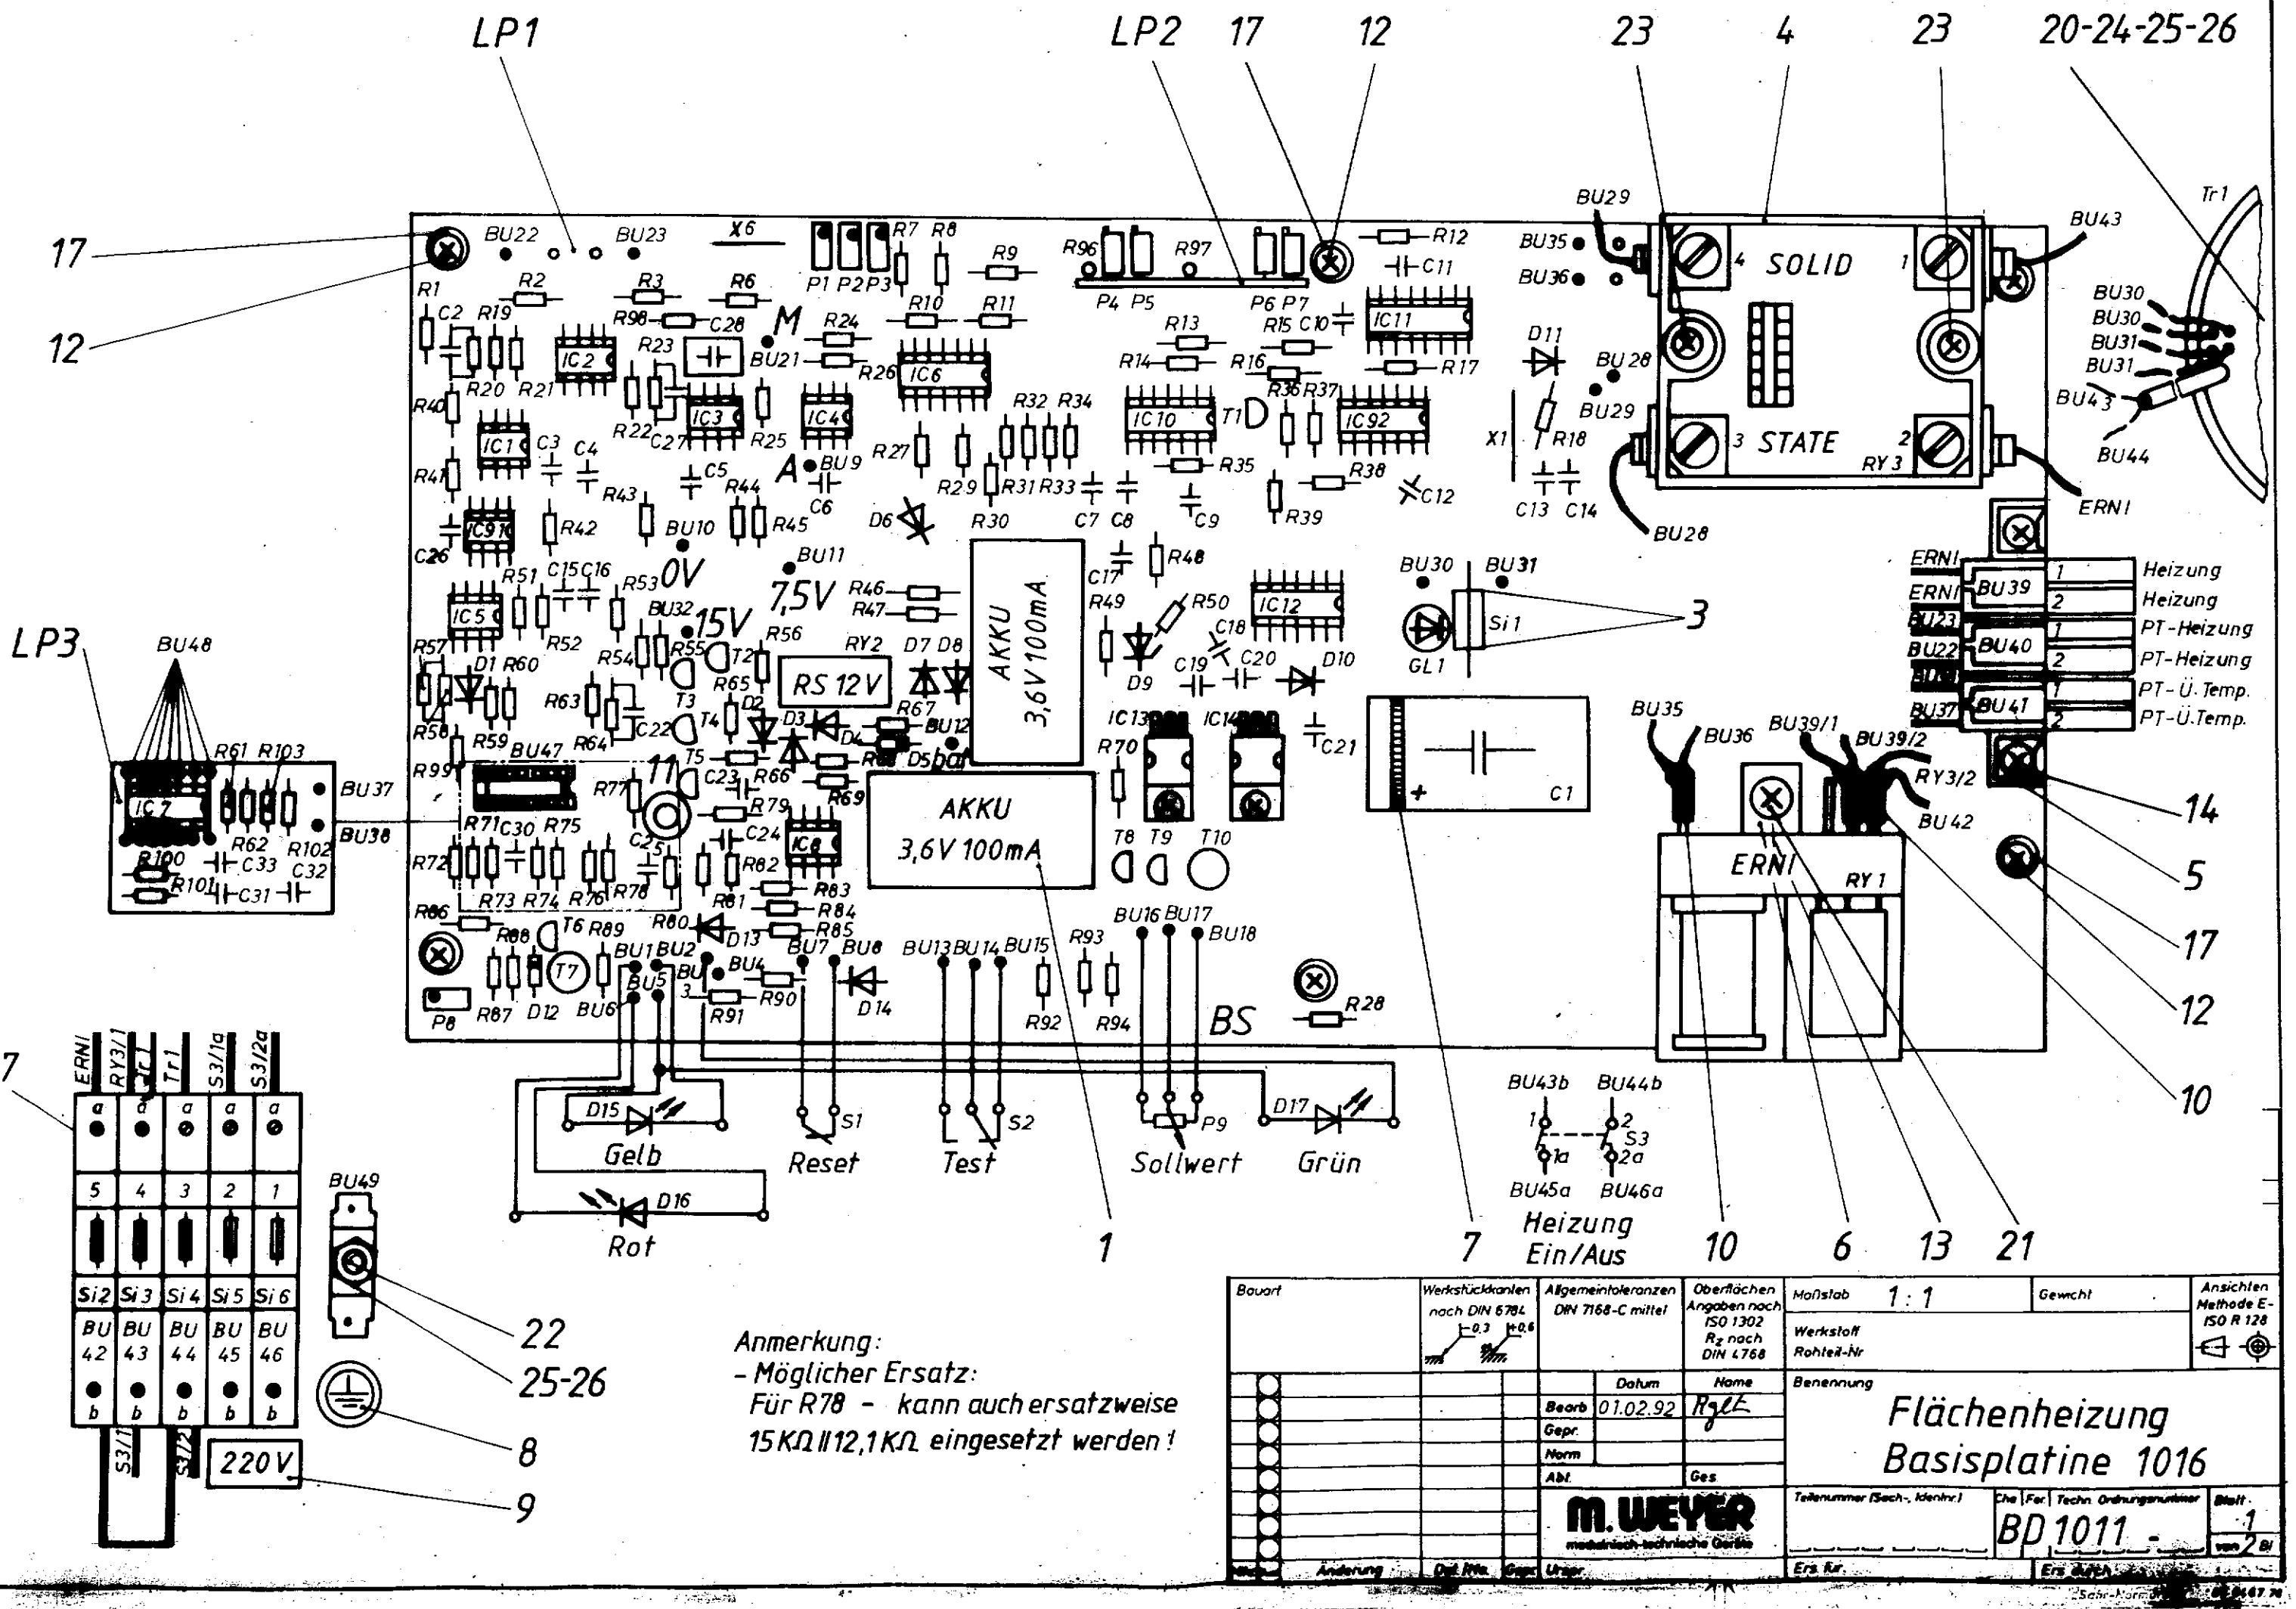
LP1
LP2
17
12
23
4
23
20-24-25-26
LP3
SOLID
STATE
ERNI
RY3
RY1
RY3/2
AKKU
3,6V 100mA
RS 12V
0V
7,5V
15V
M
A
D
BS
Tr1
Si1
GL1
C1
Gelb
Rot
Reset
Test
Sollwert
Grün
Heizung
Ein/Aus
Heizung
PT-Heizung
PT-Heizung
PT-Ü. Temp.
PT-Ü.Temp.
220V
Si2 Si3 Si4 Si5 Si6
BU 42 BU 43 BU 44 BU 45 BU 46
S3/1a
S3/2a
S3/1
S3/2
S3
BU43b
BU44b
BU45a
BU46a
1a
2a
Anmerkung:
- Möglicher Ersatz:
Für R78 - kann auch ersatzweise
15KΩ||12,1KΩ eingesetzt werden!
M. WEYER
medizinisch-technische Geräte
Flächenheizung
Basisplatine 1016
BP 1011 -
Maßstab 1:1
Gewicht
Werkstoff
Rohteil-Nr
Bearb 01.02.92
Ansichten Methode E- ISO R 128

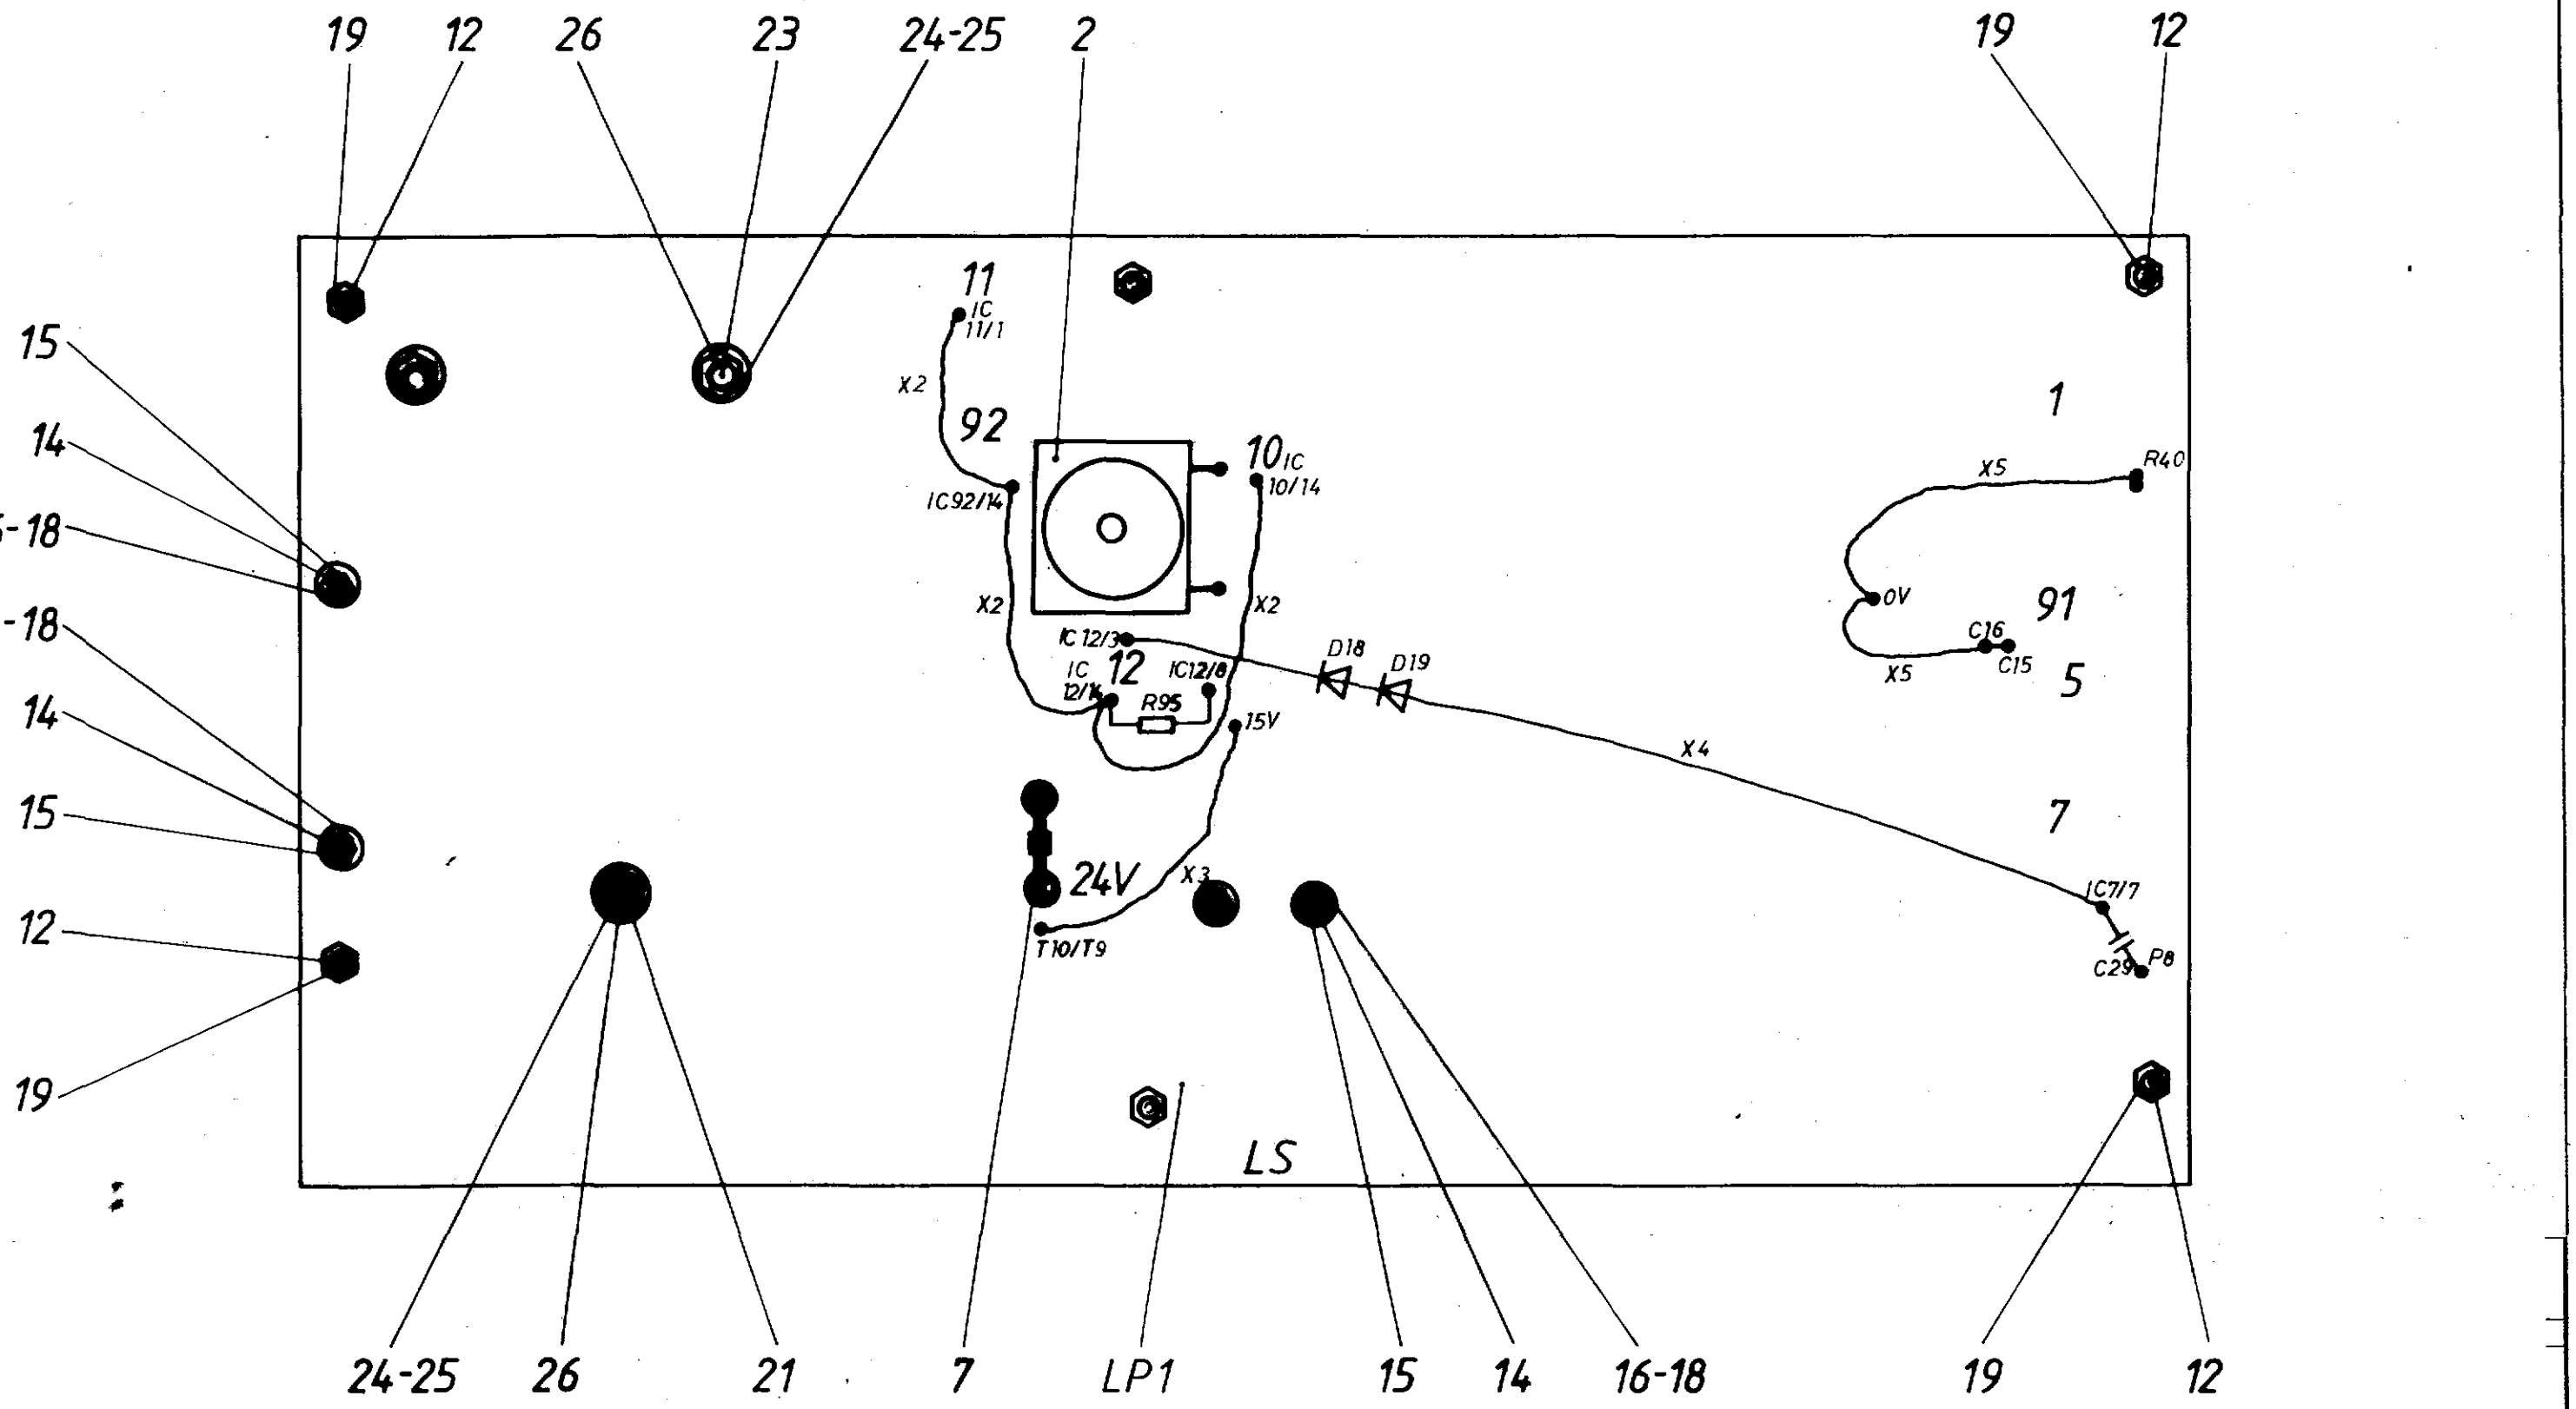

Bauort	Werkstückkanten nach DIN 6784	Allgemeintoleranzen DIN 7168-C mittel	Oberflächen Angaben nach ISO 1302 R_z nach DIN 4768	Maßstab 1:1	Gewicht	Ansichten Methode E- ISO R 128
				Werkstoff Rohteil-Nr		
		Datum	Name	Benennung	Flächenheizung Basisplatine 1016	
		Bearb 14.01.92				
		Gepr				
		Norm				
		Abt	Ges.			
Änderung	Dat./Na.	Gepr.	Urspr.	M. WEYER medizinisch-technische Geräte	Teilenummer (Soch-, Identnr.)	Cha / For / Techn. Ordnungsnummer: BD 1011 _ / Blatt: 2 von 2 Bl.
					Ers. für	Ers. durch